

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Z-News!

Viermal pro Jahr informieren wir Sie mit den Z-News über neue Produkte, Analysen und Dienstleistungen sowie geänderte Vorschriften des ZLZ's. Eine feste Rubrik mit den Daten der monatlichen Wartungstermine runden die Z-News ab. Das damit verbundene Ziel ist Ihre frühzeitige Information über Neuerungen und Aktuelles.

Anregungen von Ihrer Seite nehmen wir gerne entgegen!


Viel Lesevergnügen und beste Grüsse

Ihr ZLZ-Team
Kommunikation & Sales

Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns an
044 386 45 45

Z-Lex (Analysen) online

Wir sind wieder online mit dem neu gestalteten und aktuellen Analysenspektrum. Das umfangreiche [Z-Lex](#) auf [zlz.ch](#) beantwortet Ihnen alle Fragen zu den gängigen Analysen. Können Sie etwas nicht finden, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter info@zlh.ch.

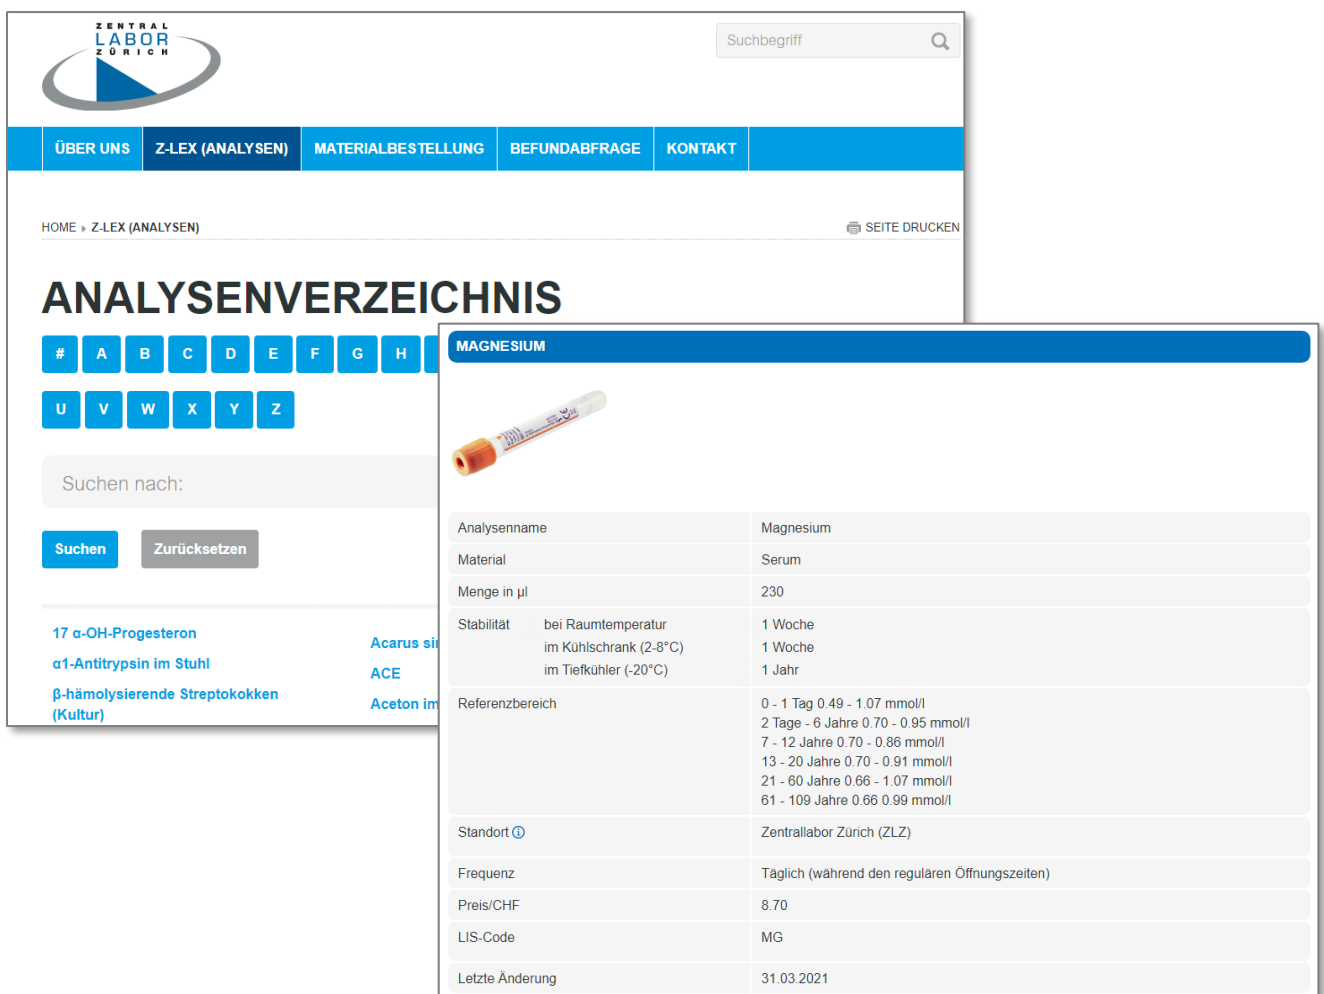

The screenshot shows the Z-Lex online analysis catalog interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Suchbegriff'. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'ÜBER UNS', 'Z-LEX (ANALYSEN)', 'MATERIALBESTELLUNG', 'BEFUNDABFRAGE', and 'KONTAKT'. The main content area is titled 'ANALYSENVERZEICHNIS' and features a grid of buttons for letters A through Z. A search input field with the placeholder 'Suchen nach:' and 'Suchen' and 'Zurücksetzen' buttons is also present. A detailed view for 'MAGNESIUM' is shown, including an image of a test tube and a table of analysis parameters.

MAGNESIUM	
Analysename	Magnesium
Material	Serum
Menge in µl	230
Stabilität	bei Raumtemperatur 1 Woche im Kühlschrank (2-8°C) 1 Woche im Tiefkühler (-20°C) 1 Jahr
Referenzbereich	0 - 1 Tag 0.49 - 1.07 mmol/l 2 Tage - 6 Jahre 0.70 - 0.95 mmol/l 7 - 12 Jahre 0.70 - 0.86 mmol/l 13 - 20 Jahre 0.70 - 0.91 mmol/l 21 - 60 Jahre 0.66 - 1.07 mmol/l 61 - 109 Jahre 0.66 0.99 mmol/l
Standort	Zentrallabor Zürich (ZLZ)
Frequenz	Täglich (während den regulären Öffnungszeiten)
Preis/CHF	8.70
LIS-Code	MG
Letzte Änderung	31.03.2021

Anpassungen bei Punktat-/Liquor-Auftragsformularen Neue Polypropylen-Röhrchen für Punktionen



Für Punktionen und Liquor-Entnahmen führt das Labor angepasste Auftragsformulare ein. Aus Gründen der Sicherheit werden die bis jetzt verwendeten nativ Glas-Röhrchen mit einem roten Deckel für Punktionen durch ein Polypropylen-Röhrchen ohne Zusatz und mit weissem Deckel ersetzt.



Bei der **ersten Bestellung** (mit Bestellformular) für diese neuen Formulare erhalten Sie **ab 1. Mai 2021** automatisch die neuen Sets mit den angepassten Auftragsformularen und den neuen Polypropylen-Röhrchen. Sobald Sie nach Ihrer Bestellung die ersten neuen Formulare und Sets erhalten haben, bitten wir Sie, die alten Formulare und Sets zu entsorgen oder an das Labor zurück zu senden.

Mit dem neuen Auftragsformular besteht die Möglichkeit, **Profile für Punktat- und Liquor-Analysen zu hinterlegen**. Bitte melden Sie die gewünschten Profile an customerservice@zlz.ch.

Sollten Sie Fragen zum angepassten Auftragsformular, zum neuen Polypropylen-Röhrchen oder andere Anliegen haben – wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter Telefon 044 386 45 83.

Website zlz.ch – Neue Rubrik «Materialbestellung»

Das ZLZ stellt den Einsender-Kliniken diverses Entnahmematerial und Labor-Auftragsformulare zur Verfügung. Bestellungen können jederzeit getätigt werden, die Lieferungen erfolgen:

Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr

innerhalb von 24 bis 72 Stunden
(ausgenommen Wochenenden und Feiertage)

Jede Bestellung ist schriftlich mit dem Formular Materialbestellung einzureichen.

Das ausgefüllte Formular Materialbestellung können Sie wie folgt zustellen:

per Mail an materialorder@zlz.ch

per Fax an die Nummer 044 386 45 55

per Post an Zentrallabor Zürich, Forchstrasse 454, 8702 Zollikon

Wartungsächte

Mittwoch, 21. April 2021

Mittwoch, 26. Mai 2021

Mittwoch, 30. Juni 2021

Mittwoch, 25. August 2021

Wartungsarbeiten von 00.30 bis 06.30 Uhr.

Die Kliniken erhalten drei Tage vor der Wartungs-
nacht ein entsprechendes
Rundschreiben per Mail.